

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 9

zestaw 1 [zam.: 13.10.2020]	2
zestaw 2 [zam.: 15.10.2020]	4

1

[pakiet 20, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zarówno papier z nadrukiem, jak i bez nadruku.

2

[pakiet 20, poz. 6](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zarówno papier z nadrukiem, jak i bez nadruku.

3

[pakiet 20, poz. 9](#)**Pytanie:**

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający oczekuje przewodów dołączeniowych przeznaczonych do kabli zakończonych wtykami bananowymi 4mm a po stronie elektrod EKG zakończonych klamrą?

zdjęcie poniżej

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z SIWZ oczekuje adaptera z wtykami banan przechodzącymi w klamrę.

4

[pakiet 20, poz. 10](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie zakończenia kabla po stronie pacjenta: wtyk bananowy, klamra, zatrask.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

5

[pakiet 20, poz. 11](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 44mm x 30 mm, prostokątnej, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

6

[pakiet 20, poz. 12](#)

Pytanie:

Wracamy się z prośbą o wskazanie ilości żelu do USG i osobno do EKG.

Powyższe żele oprócz różnego zastosowania mają także różne ceny.

Odpowiedź:

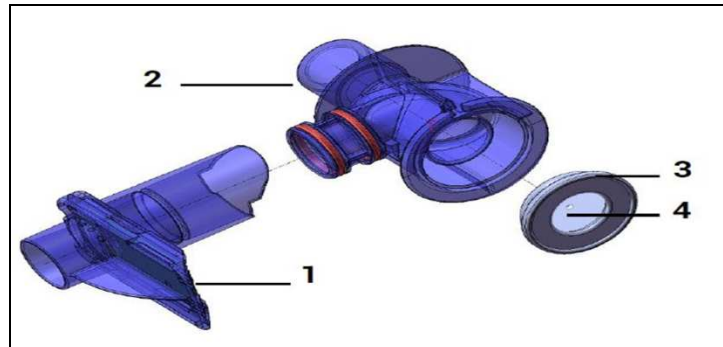
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający oczekuje żelu możliwego do zastosowania zarówno w USG jak i EKG.

1

[pakiet 10, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pod nazwą „uszczelka pod zastawkę wydechową do respiratora Monnal T75” miał na myśli membranę Monnal EVA zaznaczoną na poniższym schemacie cyfrą 3?

**Odpowiedź:**

Tak

2

[pakiet 10, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie akcesoriów w najmniejszym możliwym do oferowania opakowaniu producenta (1 opak. – 5 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3

[pakiet 21, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pozycji 1, tj. Adapter CO2 w oryginalnym opakowaniu producenta (1 opak. – 50 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4

[pakiet 21, poz. 11](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pozycji 11, tj. Uniwersalny czujnik SpO2, jednorazowy do zastosowania z klipszem na ucho z pozycji 4, w oryginalnym opakowaniu producenta? (1 opak. – 5 szt.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5

[pakiet 21, poz. 12](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pozycji 12 tj. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia w oryginalnych opakowaniach producenta (1 opak. – 10 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6

[pakiet 21, poz. 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pozycji 13, tj. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca w oryginalnym opakowaniu producenta (1 opak. – 5 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7

[projekt umowy: § 6](#)**Pytanie:****§ 6 Zabezpieczenie interesów Zamawiającego / kary umowne**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za której mowa w § 6 pkt 3 z 20% do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

8

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie wielorazowego pojemnika na wapno opisanego w pakiecie nr 7 poz. 5 w komplecie z pokrywą opisaną w pakiecie 7 poz.1.

Prosimy o dopuszczenie modyfikacji tabeli w załączniku nr 1 według poniższego wzoru.

Dostarczenie pojemnika na wapna wraz z pokrywą w komplecie jest dla Zamawiającego korzystniejsze cenowo.

I.p.	Pakiet 7 Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	ilość
1	Pokrywa do wielorazowego pojemnika na wapno, kompatybilnego z aparatem do znieczulenia Leon Plus.	sztuka	1
2	Filtr antybakteryjny, hydrofobowy do ssaka kompatybilny z aparatem Leon Plus.	sztuka	30
3	Pułapka wodna dla pacjentów dorosłych do analizatora gazów anestetycznych, kompatybilna z aparatem do znieczulenia Leon Plus.	sztuka	10
4	Kopułka/wziernik pozwalająca na kontrolę pracy membran zastawki wdechowej i wydechowej kompatybilna z modułem pacjenta aparatu do znieczulenia Leon Plus.	sztuka	4
5	Wielorazowy pojemnik na wapno, przezroczysty, pojemność min. 1700 ml wraz z pokrywą do wielorazowego pojemnika na wapno, kompatybilne z aparatem do znieczulenia Leon Plus.	sztuka	1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9

[pakiet 32, poz. 2-3](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

10

[pakiet 32, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ, który jest wyrobem medycznym.

11

*pakiet 32, poz. 2***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

12

*pakiet 32, poz. 3***Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

Zgodnie z § 2 projektu umowy:

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

- 1) foldery, katalogi bądź inną dokumentację, potwierdzającą parametry dostarczanego przedmiotu;
- 2) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę materiał posiadają odpowiednie dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, świadectwa, certyfikaty CE, deklaracja zgodności – zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy).

13

*pakiet 32, poz. 2÷3***Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14

*pakiet 32, poz. 2, 3, 4, 9***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

15

*pakiet 32, poz. 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150cm?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z SIWZ.

16

*pakiet 32, poz. 3***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z filtrem airstopem zapobiega się przedostawaniu powietrza do linii z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ

17

*pakiet 32, poz. 4***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu w kształcie beczułki z regulatorem przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% do 5-200ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

Zamawiający określa przepływ jedynie dla standardowego płynu infuzyjnego.

18

[pakiet 32, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP z 2 paskami widniejącymi w promieniach RTG z polimerowm zatrzaskiem z filtrem hydrofobowym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

19

[pakiet 24](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 32ml, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z korektą SIWZ.

20

[pakiet 25](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane w zwoju o długości 50m, z mankietem co 20cm, średnica 22mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

21

[pakiet 24](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oddechowy hydrofobowy, elektrostatyczny filtr bakteryjno- wirusowy, skuteczność 99,9 %, przestrzeń martwa 34 ml; waga 19g, złącze 22F/15M, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zgodnie z korektą SIWZ.

22

[pakiet 26, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażonego w zastawkę, która otwiera i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona;

- pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml;
- działa w pozycji pionowej i poziomej;
- szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami.

W zestawie dren 180 cm, czysty biologicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

23

[pakiet 26, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy, dwuświatłowy tzw. rura w rurze, o długości 1,6 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową gładką wewnętrzną rurą 1,5m, w zestawie 2 litrowym workiem bezlateksowym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

24

[pakiet 26, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowa maseczka tlenowa z drenem i nebulizatorem, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego (bez ftalanów) polipropylenu. Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości 2,1 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

25

[projekt umowy: § 6, ust. 3](#)**Pytanie:**

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w § 6 ust 3 do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

26

[pakiet 26, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora ma być kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora dla prawidłowego podłączenia i łatwej identyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

27

[pakiet 26, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przestrzeni martwej o długości ok. 15 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z korekta SIWZ.

28

[pakiet 26, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przestrzeń martwa ma posiadać na opakowaniu jednostkowym piktogram z opisanymi rozmiarami złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

29

[pakiet 26, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do podawania leku w obwodzie oddechowym, ma być pakowany w 3 osobne opakowania (każdy element pakowany oddzielnie: nebulizator, łącznik T i przestrzeń martwa), co umożliwi ekonomiczne i prawidłowe wykorzystanie konkretnego elementu produktu pod konkretnego pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

30

[pakiet 26, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez wymóg: „zakończenie uniwersalne łącznika” drenu, Zamawiający oczekuje łącznika uniwersalnego, który umożliwi podłączenie do aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź:

Tak. Zakończenie uniwersalne powinno umożliwić podłączenie do aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

31

[pakiet 26, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje nebulizatora skalowanego co 1 ml w zakresie 2-5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego SIWZ.

32*pakiet 26, poz. 3***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nebulizator ma być pozbawione DEHP, bisfenolu (BPA) oraz powinien być przyjazny środowisku MRI (bez metalowych części)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego SIWZ, który jest wyrobem medycznym.

33*pakiet 24, poz. 1***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa max. 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zgodnie z korektą SIWZ.

34*pakiet 24, poz. 1***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port kapno w filtrze elektrostatycznym powinien posiadać zatyczką na uwięzi, co uniemożliwia jego przypadkowe usunięcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

35*pakiet 13, poz. 2***Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych jednorazowych do strzygarki Becare używanej aktualnie na bloku operacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

36*pakiet 19***Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie ostrza uniwersalnego jednorazowego użytku o szerokości cięcia co najmniej 36 mm.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką BeCare, którą oferent w ilości 5 sztuk zobowiązuje się dostarczyć do szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ, który jest kompatybilny z posiadanymi i zakupionymi wcześniej w ramach postępowania strzygarkami chirurgicznymi.

37*projekt umowy: § 6***Pytanie:**

Prosimy o obniżenie kar par. 6, pkt 3 do 10 %, oraz par 6 pkt 2 do 0,5 %.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.