

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 5

zestaw 1 [zam.: 22.12.2020]	2
zestaw 2 [zam.: 23.12.2020]	3

zestaw 1

zam.: 22.12.2020 r.

1**Pytanie:**

Czy w związku z panującą sytuacją epidemiczną Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanej podpisem elektronicznym na pomocą dedykowanej platformy bądź na adres mailowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2*[pakiet 7, poz. 1](#)***Pytanie:**

Czy do kabla będą podłączane pincety bipolarne ze złączem EU?

Odpowiedź:

Będą podłączane pincety bipolarne ze złączem EU.

3*[pakiet 8](#)***Pytanie:**

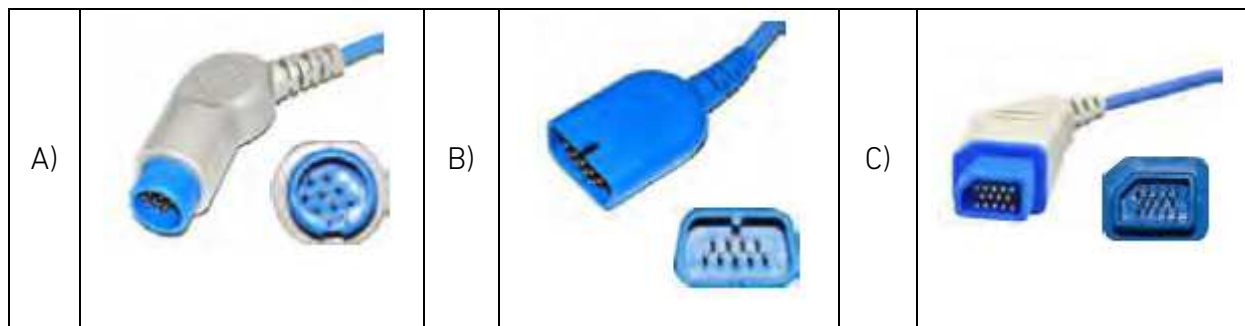
Prosimy o **wydłużenie** czasu realizacji zamówienia w **Pakiecie 8** do 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1

pakiet 3

Pytanie:Prosimy Zamawiającego o określenie rodzaju wtyczki dla adapteru SpO₂:**Odpowiedź:**

Wejście i wyjście kabla głównego zgodnie z załączonym zdjęciem.



2

pakiet 3

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rodzaju wtyczki dla kabla głównego:

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonym obrazem.

3

pakiet 2

Pytanie:

Czy zamawiający oczekuje:

Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz - zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennie, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza.

Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

Zamawiający dołącza zdjęcie końcówki, do której ma zostać podłączony zestaw do monitorowania ciśnienia IBP/OCŻ.



3

projekt umowy: § 6, ust. 2

Pytanie:

Wnosimy o **zmniejszenie kar umownych** określonych w § 6 ust 2 do 0,5 %.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

4

projekt umowy: § 6, ust. 3

Pytanie:

Wnosimy o **zmniejszenie kar umownych** określonych w § 6 ust 3 do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

5

pakiet 3, poz. 5

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania oryginalny Czujnik SpO2 producenta kardiomonitora jednorazowego użytku w opakowaniu zbiorczym 5szt.?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6

[SIWZ: Rozdział 10, pkt 10.4](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert środkami komunikacji elektronicznej podpisanej kwalifikowanych podpisem elektronicznym, co w obecnym okresie rekomenduje Urząd Zamówień Publicznych?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.